



【新薬】 処方箋医薬品 注意-医師等の処方箋により使用すること

持続性ソマトスタチンアナログ マイクロスフェア型徐放性製剤 薬価基準収載

# シグニフォー<sup>®</sup>LAR<sup>®</sup> 筋注用キット

Signifor<sup>®</sup> LAR<sup>®</sup> kit 10mg, 20mg, 30mg, 40mg, 60mg

パシレオチドパモ酸塩徐放性製剤

10mg  
20mg  
30mg  
40mg  
60mg



医療関係者用

## 調製及び注射方法

### キット梱包内容

#### 準備するもの

注射針(20ゲージ)1本  
※その他、必要に応じて、予備用注射針や消毒用アルコール綿等をご準備下さい。



シグニフォー<sup>®</sup>LAR<sup>®</sup>筋注用(バイアル)

調製用バイアルアダプター

専用分散液(シリンジ) プランジャー

**注意** 再使用しないで下さい。  
包装や製品に破損等がみられる場合は使用しないで下さい。

### 使用前の注意


- 使用前にはシグニフォー<sup>®</sup>LAR<sup>®</sup>筋注用(バイアル)および専用分散液(シリンジ)を最低30分室温で静置して下さい。室温に戻した後24時間以内の使用が望まれます。
- 調製は必ず付属の専用分散液およびバイアルアダプターを使用して下さい。
- 用時調製し、懸濁後は直ちに使用して下さい。

### 1 バイアルを開ける




- バイアルのキャップを取り、アルコール綿でバイアルのゴム栓を拭いて下さい。

### 2 専用分散液のセット

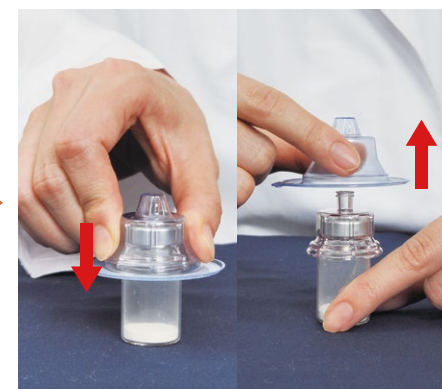

- フィルムを取り除いたブリスタートレー付きの調製用バイアルアダプターをバイアルの真上に置き、カチッという音がするところまで十分に押し込んで下さい。
- ブリスタートレーを垂直方向に引き上げ、バイアルアダプターからブリスタートレーをはずして下さい。

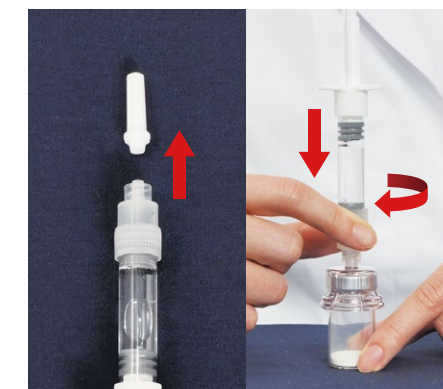

- 調製用の専用分散液が充てんされたシリンジからキャップを引き抜き、シリンジを回しながらバイアルアダプターに取り付けて下さい。

### 3 専用分散液の充てん



- プランジャーをゆっくり押し下げ、専用分散液全量をバイアル内に注入して下さい。

**静置不要**  
(サンドスタチン<sup>®</sup>LAR<sup>®</sup>では必要)

### 4 薬液の攪拌



- プランジャーを押し下げたままの状態、粉末が完全に懸濁するまで、水平方向に穏やかに振って下さい(約30秒間)。懸濁が不十分な場合はさらに30秒間、穏やかに振ります。  
※この時までには、患者さんには側臥位の姿勢で待機してもらいたい。

### 5 吸引・針取り付け



- シリンジとバイアルを逆にし、プランジャーをゆっくり引いて、全内容をバイアルからシリンジに吸引して下さい。




- シリンジを回しながら、バイアルアダプターからはずして下さい。



- 注射針をシリンジに回しながら取り付けて下さい。
- シリンジ内での沈殿を避け均一な懸濁液を保つため、シリンジを静かに振って下さい。
- シリンジ内の空気を抜き、直ちに注射して下さい。

### 6 注射位置

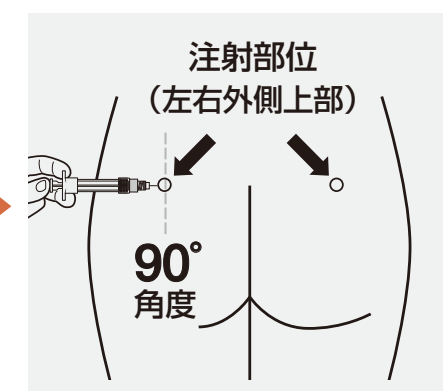

- 左右いずれかの臀部注射部位をアルコール綿で消毒し、筋肉内に全量を注射して下さい。
  - 注射針は刺入部位に対し90度の角度で注射して下さい。
  - 静脈内には注射しないで下さい。
- ⚠️ 左右交互に注射して同一部位への投与は避けて下さい。  
⚠️ 側臥位の姿勢で注射して下さい。

### 7 注射



- 側臥位の患者さんにほぼ水平に注射します。
  - 患者さんに激痛やしびれがないか聞いてから、プランジャーを一旦引いて血液が逆流しないことを確認して下さい。血液の逆流が認められなければ一定の圧力で注入します。
- ⚠️ 注射後は、注射部位をもまないで下さい。